

---

# Bruksanvisning

## 03.809.925S Ljusclips för Oracle-sårhake, sterilt

Denna bruksanvisning är inte avsedd för distribution i USA.

Alla produkter är för närvarande inte tillgängliga på alla marknader.



### **Authorized Representative**

DePuy Ireland UC  
Loughbeg  
Ringaskiddy  
Co. Cork Ireland

# Bruksanvisning

03.809.9255 Ljusclips för Oracle-sårhake, sterilt

Ljusclipset är ett sterilt fiberoptiskt plastinstrument avsett för engångsbruk som används för att ge sval belysning av djupt liggande operationsställen. Ljusclipset är avsett att användas med en 300 W-xenonlampa tillsammans med en 3 mm fiberoptisk kabel med ACMI-honkontakt.

Viktig anmärkning för sjukvårdspersonal och personal på operationssalar: Denna bruksanvisning innehåller inte all den information som är nödvändig för val och användning av en produkt. Läs bruksanvisningen och broschyren "Viktig information" från Synthes noggrant före användning. Säkerställ att du är väl insatt i lämplig operationsmetod.

## Material

Fiberoptisk kabel för medicinskt och optiskt bruk, polymerer.

## Avsedd användning

Ljusclipset är avsett för belysning vid operation, i synnerhet i situationer där djupa hålrum eller kringliggande vävnad gör att ordinarie operationsbelysning inte når fram till operationsstället i tillräcklig utsträckning. Det är avsett för användning vid mindre invasiv ryggradskirurgi.

## Indikationer/kontraindikationer

Om Ljusclips (03.809.9255) används i kombination med implantat eller instrument, se respektive bruksanvisning för indikationer och kontraindikationer och ytterligare kirurgiska åtgärder.

## Patientmålgrupp

Produkten ska användas med hänsyn till dess avsedda användning, indikationer, kontraindikationer och med överväganden avseende anatomin och patientens hälsotillstånd.

Patientmålgruppen är baserade på de implanterade produkterna snarare än instrumenten. Specifik patientmålgrupp för implantaten finns i respektive implantats bruksanvisning.

## Avsedd användare

Denna produkt är avsedd för användning av kvalificerad sjukvårdspersonal t.ex. kirurger, läkare, operationssalspersonal och personer som är involverade i förberedelse av produkten. All personal som hanterar produkten ska vara fullt medveten om bruksanvisningen, de kirurgiska ingreppen i tillämpliga fall och/eller Synthes broschyr "Viktig information" enligt vad som är lämpligt.

## Potentiella negativa händelser, oönskade biverkningar och återstående risker

Synthes tillverkar kirurgiska instrument avsedda att förbereda implantationsstället och hjälpa till med implantation av Synthes-implantat. De negativa händelserna/biverkningarna är baserade på implantatensheterna snarare än instrumenten. Specifika negativa händelser/biverkningar för implantaten finns i respektive Synthes bruksanvisning för implantat.

## Steril produkt

**STERILE EO** Steriliserad med etylenoxid

Förvara sterila enheter i ursprunglig skyddsförpackning och ta inte ut dem ur förpackningen förrän omedelbart före användning.


 Använd inte om förpackningen är skadad.

Kontrollera produktens utgångsdatum före användning och kontrollera att steriltförpackningen är hel. Använd inte om förpackningen är skadad eller om utgångsdatum är passerat.

 Återsterilisera inte

Återsterilisering av Ljusclips (03.809.9255) kan resultera i att produkten inte är steril och/eller inte uppfyller prestandaspecifikationer och/eller förändrade materialegenskaper.

## Produkt för engångsbruk

 Får ej återanvändas

Indikerar en medicinteknisk produkt som är avsedd för engångsbruk eller för användning på endast en patient under endast ett ingrepp.

Återanvändning eller reprocessing (t.ex. rengöring och omsterilisering) kan kompromettera produktens strukturella integritet och/eller leda till att produkten inte fungerar, vilket i sin tur kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Dessutom kan återanvändning eller reprocessing av produkter för engångsbruk utgöra en risk för kontamination, t.ex. på grund av överföring av smitöamnen från en patient till en annan. Detta kan leda till skada på patient eller användare samt dödsfall.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

- Användaren ska vara väl införstådd med hur ljuskällor och kablar används och vidta försiktighetsåtgärder i enlighet med detta.
- Använd inte ljuskällan och kabeln utan Ljusclipset monterat. Utan Ljusclipset monterat är ljuset från den fiberoptiska kabeln mycket starkt och varmt och kan orsaka brännskador, antända material som bomullspinnar/draperingar/patientrockar eller orsaka tillfällig blindhet.
- Ljusclipset är avsett för användning med 300 W-xenonlampor tillsammans med en 3 mm fiberoptisk kabel. Använd inte ljuskällor med högre effekt än 300 W eller kablar där det fiberoptiska knippets diameter överstiger 3 mm. Användning av högre effekt eller kablar med större diameter kan leda till överhettning, vilket kan orsaka produktfel och patientskada. Om Ljusclipset får hack eller skärskador, om vätska ansamlas inuti det, eller om det förefaller vara trasigt eller skadat på något sätt måste det bytas ut för att minimera risken för patientskada.
- Emissionen av synligt och infrarött ljus varierar mycket mellan olika ljuskällor. Som en försiktighetsåtgärd bör du kontrollera kontaktens temperatur då och då första gången en ny ljuskälla används och därefter vid behov. Metalldelen på kontakten kan bli mycket varm, vilket är helt normalt vid användning av fiberoptisk utrustning. Använd plastgreppet som ett handtag. Se illustrationen. Placera inte kontakten så att metallringen kommer i direkt kontakt med patientens hud.
- Eftersom ljusenergi kan absorberas som värme ska hela den tända delen (den distala änden) av Ljusclipset inte ligga kontinuerligt inbäddat (d.v.s. den tända ytan ska inte vara fullständigt begrävd) i vävnad och hållas fixerad i mer än några minuter i taget.
- Alla komponenter måste räknas av innan operationssåret försluts. Förpackningen med Ljusclipset innehåller en Ljusclipsenhet med ett papperskydd fastsatt. Innan Ljusclipset används ska skyddet avlägsnas och kasseras.
- Efter användning utgör denna produkt potentiellt biologiskt riskavfall. Hantera och kassera det i enlighet med vedertagen medicinsk praxis och tillämpliga lokala förordningar.

Ytterligare information finns i broschyren "Viktig information" från Synthes.

## Kombination av medicintekniska produkter

Synthes har inte utfört tester gällande kompatibilitet med produkter som tillhandahålls av andra tillverkare och påtar sig inget ansvar i sådana fall.

Ljusclipset (03.809.9255) är avsett att användas med högst 300 W-xenonljuskälla, med användning av en 3 mm fiberoptisk kabel (eller mindre) med en motsvarande anslutning/adapter (ACMI honkontakt).

Följ bruksanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna från ljuskällans tillverkare.

## MR-miljö (magnetisk resonansmiljö)

Ej MR-säker: Den medicintekniska produkten 03.809.9255 är inte MR-säker enligt ASTM F 2052, ASTM F 2213, ASTM F 2182.

## Behandling innan produkten används

Steril produkt:

Produkterna tillhandahålls sterila. Avlägsna produkterna ur förpackningen med hjälp av ett aseptiskt förfarande.


Förvara sterila enheter i ursprunglig skyddsförpackning och ta inte ut dem ur förpackningen förrän omedelbart före användning.

Kontrollera produktens utgångsdatum före användning och kontrollera att steriltförpackningen är hel. Får inte användas om förpackningen är skadad.

## Kassering

Produkter måste kasseras som medicinteknisk produkt för sjukvården i enlighet med sjukhusets rutiner.

## Särskilda användningsinstruktioner

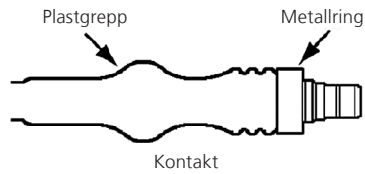

- Anslut ljusclipset till korrekt Synthes-sårhake. Ljusclipset ska klämmas fast på lämplig sårhake.
- Ljusclipset ska anslutas till en ljuskälla avsedd för pannlampor eller endoskop. En fiberoptisk kabel ansluts mellan ljuskällan och ljusclipset. Kontrollera att ljusclipsets kontakt är säkert ansluten till kabeln. Kabeln ska vara i gott skick med ren optik. Smutsig optik eller kablar som behöver repareras kan orsaka överhettning i kontakterna.
- Genom att tona ner den takbelysningen kan synligheten vid operationsstället förbättras.
- Kroppsvätskor eller skräp som samlas på ljusclipsets yta kan spolås eller torkas bort.

## Garanti

Alla rättigheter enligt garantin upphävs om reparationer eller modifieringar utförs av ett obehörigt servicecenter. Tillverkaren tar inget ansvar för inverkan på produktens säkerhet, tillförlitlighet eller prestanda om den inte används i enlighet med bruksanvisningen.

CE  
0123



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
[www.jnjmedicaldevices.com](http://www.jnjmedicaldevices.com)