

---

# Uputstvo za upotrebu

## 03.809.925S Klipsa za svetlo za Oracle retraktor, sterilna

Nije predviđeno da se ovo uputstvo distribuira u SAD.

# Uputstvo za upotrebu

03.809.925S Klipsa za svetlo za Oracle retraktor

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, Synthes brošuru „Važne informacije“ i odgovarajuće hirurške tehnike. Postaraćete se da se upoznate sa odgovarajućom hirurškom tehnikom.

## Materijal

Optički kabl medicinske i optičke klase  
Polimeri

Klipsa za svetlo je sterilan plastični optički uređaj za jednokratnu upotrebu namenjen za osvetljenje hladnog tona dubokih hirurških lokacija. Klipsa za svetlo namenjena je za korištenje sa ksenonskim osvetljivačem od 300 vati, korištenjem optičkog kabla 3 mm sa ženskim ACMI konektorom.

## Namena

Klipsa za svetlo namenjena je za osvetljenje hirurških procedura, naročito onih kod kojih duboke šupljine ili susedna tkiva ograničavaju spolašnje osvetljenje hirurškog polja. Projektovana je za korištenje u manje invazivnoj hirurgiji kičmenog stuba.

## Indikacije/kontraindikacije

Klipsa za svetlo treba da se koristi u kombinaciji sa sistemima za pristup. Za indikacije i kontraindikacije pogledajte odgovarajuće hirurške tehnike za ugradnju implantata.

## Sterilno medicinsko sredstvo

**STERILE EO** Sterilisano korištenjem etilen-oksida

Medicinska sredstva čuvajte u originalnom zaštitnom pakovanju i ne vadite ih iz pakovanja do neposredno pre upotrebe. Pre upotrebe proverite rok upotrebe i uverite se u celovitost sterilnog pakovanja. Ne koristite ako je pakovanje oštećeno.

## Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu

 Ne koristite više puta

Proizvodi namenjeni jednokratnoj upotrebi ne smiju se koristiti više puta. Ponovna upotreba ili obrada (npr. čišćenje ili ponovna sterilizacija) mogu da naruše strukturu celovitosti medicinskog sredstva i/ili dovedu do kvara medicinskog sredstva, što može izazvati povređivanje, bolest ili smrt pacijenta. Osim toga, ponovna upotreba ili sterilizacija medicinskog sredstva za jednokratnu upotrebu mogu da stvore rizik od kontaminacije npr. usled prenosa infektivnog materijala sa jednog pacijenta na drugog. Ovo bi moglo da dovede do povređivanja ili smrти pacijenta ili korisnika.

## Upozorenja

Korisnik treba da se upozna sa korištenjem izvora svetlosti i kablova i treba da preduzme mere opreza u skladu sa tim.

Nemojte rukovati izvorom svetlosti i kablom bez pričvršćene klipse za svetlo. Bez klipse za svetlo izlaz sa optičkog kabla je izuzetno svetao, vruć i može da izazove opekotine, zapali materijale, kao što su štapići za uši / zavesu / mantili, ili izazove privremeno slepilo.

Klipsa za svetlo je namenjena za korištenje sa ksenonskim osvetljivačima od 300 vati, korištenjem optičkog kabla od 3 mm. Nemojte koristiti izvore svetlosti nominalne snage veće od 300 vati ili kablove sa snopovima optičkih vlakana prečnika većeg od 3 mm. Upotreba izvora veće snage ili kablova većeg prečnika može da dovede do pregrevanja, što uzrokuje kvar proizvoda i povredu pacijenta. Ako se klipsa za svetlo zaseče, nakupi se tečnost u njoj, izgleda slomljeno ili oštećeno na bilo koji način, treba da se zameni da bi se smanjio rizik po pacijenta.

## Mere opreza

Izvori svetlosti dosta variraju u pogledu emisije vidljive i infracrvene energije. Kao mera opreza, preporučujemo povremeno praćenje temperature konektora tokom prve upotrebe sa novim izvorom svetlosti ili lampom; nakon toga po potrebi. Kao što je uobičajeno kod opreme sa optičkim vlaknom, metalni deo konektora može da postane suviše vruć na dodir. Koristite plastični držać kao ručku. Pogledajte ilustraciju. Ne stavljajte deo konektora sa metalnim prstenom direktno na kožu pacijenta.

Pošto svetlosna energija može da se apsorbuje kao toplota, ceo osvetljeni deo (distalni kraj) klipse za svetlo ne treba da bude neprekidno uvučen (tj. površina ne treba da bude u potpunosti pokrivena) u tkivo i da se drži fiksiran više od nekoliko minuta odjednom.

Pre zatvaranja hirurške lokacije sve komponente moraju da se prebroje. Pakovanje klipse za svetlo sadrži jedan sklop klipse za svetlo sa pričvršćenim zaštitnim pačirnim štitnikom. Pre korištenja klipse za svetlo štitnik mora da se ukloni i odloži.

Nakon korištenja ovaj proizvod može da predstavlja potencijalnu biološku opasnost. Rukujte i odložite u skladu sa prihvaćenom medicinskom praksom i lokalnim propisima.

## Uputstva za upotrebu

Pričvrstite klipsu za svetlo na odgovarajući Synthes retraktor. Klipsa za svetlo treba da bude zakačena na odgovarajući retraktor.

Klipsa za svetlo se povezuje na izvor svetlosti korišten za čeone lampe ili endoskope. Optički kabl spaja izvor svetlosti i klipsu za svetlo. Proverite da li je konektor klipse za svetlo bezbedno pričvršćen na kabl. Kabl treba da bude u dobrom stanju sa čistom optikom. Prljava optika ili kablovi kojima je potrebna popravka mogu da izazovu prekomernu toplotu na konektoru.

Okretanje osvetljenja iznad glave nadole može da poboljša vidljivost na hirurškoj lokaciji.


Telesne tečnosti ili ostaci nakupljeni na površini klipse za svetlo treba da se isperu ili izbrišu.

## Garancija

Sva garantna prava se gube ako popravke ili izmene obavljaju neovlašćeni servisni centar. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve uticaje na bezbednost, pouzdanošću ili performanse proizvoda ako proizvod nije korišten u skladu sa uputstvom za upotrebu.

## Za dodatne informacije

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o ovom proizvodu, обратите se предstavniku ili ovlašćenom prodavcu kompanije Synthes.

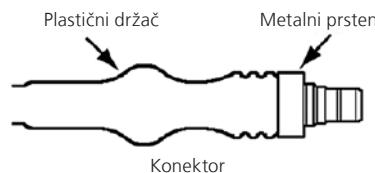

0123



Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
4436 Oberdorf  
Switzerland  
Tel: +41 61 965 61 11  
Fax: +41 61 965 66 00  
[www.depuyssynthes.com](http://www.depuyssynthes.com)